PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER CS 100-3P2

Tenzometrický snímač / snímač síly "S" z nerezové oceli

ČESKY

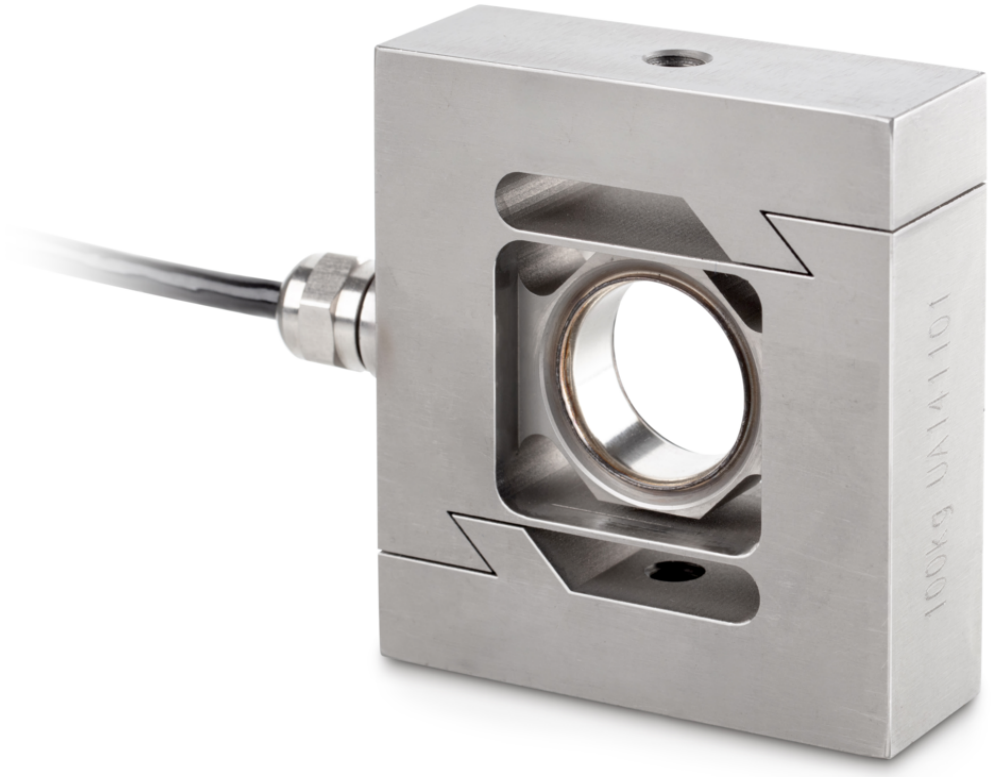

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



VLASTNOSTI

- Oblast použití: měření hmotnosti a tlakové síly
- Vhodné pro závěsné váhy, váhy pro sila, zkušební stojany pro měření síly a další různé váhy

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Rozsah měření [Max]
CS 50-3P2	50 kg	500 N
CS 100-3P2	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	2000 kg	20 kN
CS 5000-3P2	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	7500 kg	75 kN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CE RR8	Kloubová hlavice CE RR8
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,

Model	Popis
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68
FS 403	Konektor pro snímač FS, namontovaný & justovaný do 2 kN FS 403
FS TKZ	Přepravní kufr FS TKZ
YKV-01	Digitální váhový převodník YKV-01
YKV-02	Digitální váhový převodník YKV-02

SLUŽBY

Model	Popis
963-162	Kalibrační list DAkkS 963-162 (směr síly tah | jednotka výsledku měření N | postup kalibrace DKD-R 3-3 - průběh A)
963-162IV	Kalibrační list DAkkS 963-162IV (směr síly tah | jednotka výsledku měření mV/V | postup kalibrace ISO 376)
963-162V	Kalibrační list DAkkS 963-162V (směr síly tah | jednotka výsledku měření mV/V | postup kalibrace DKD-R 3-3 - průběh A)
963-262	Kalibrační list DAkkS 963-262 (směr síly tlak | jednotka výsledku měření N | postup kalibrace DKD-R 3-3 - průběh A)
963-262IV	Kalibrační list DAkkS 963-262IV (směr síly tlak | jednotka výsledku měření mV/V | postup kalibrace ISO 376)
963-262V	Kalibrační list DAkkS 963-262V (směr síly tlak | jednotka výsledku měření mV/V | Kalibrační postup DKD-R 3-3 - průběh A)
963-362	Kalibrační list DAkkS 963-362 (směr síly tah, tlak | jednotka výsledku měření N | postup kalibrace DKD-R 3-3 - průběh A)
963-362IV	Kalibrační list DAkkS 963-362IV (směr síly tah, tlak | jednotka výsledku měření mV/V | postup kalibrace ISO 376)
963-362V	Kalibrační list DAkkS 963-362V (směr síly tah, tlak | jednotka výsledku měření mV/V | Kalibrační postup DKD-R 3-3 - průběh A)
970-016	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-016

KERN přehled piktogramů



Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny