PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktová brožura

08.08.2026

# KERN 328-06

Miligramové kalibrační závaží, F1, 50 mg, plíšek, leštěná nerezová ocel

ČESKY

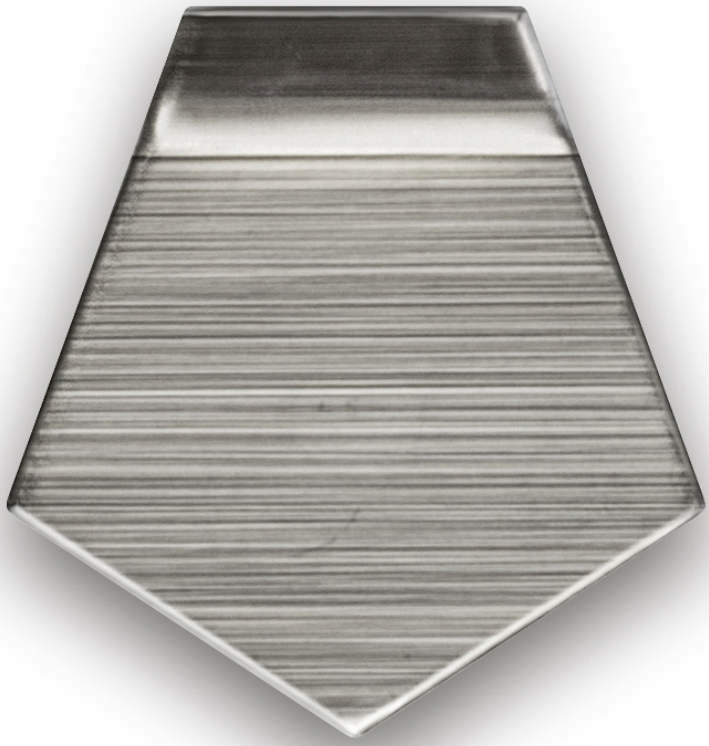

## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Německo**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Pro toto kalibrační závaží doporučujeme vzhledem k velmi přesné třídě bezpodmínečně pouzdro. Výběr naleznete v části Příslušenství

## PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně









## PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Model | Popis |
|---|---|
| 315-242 | Pinzety 315-242 (polyamid \| 100 mm) |
| 315-243 | Pinzety 315-243 (nerezová ocel \| 105 mm) |
| 315-247 | Pinzety 315-247 (nerezová ocel, plast \| 136 mm) |
| 317-009-600 | Hliníkové pouzdro na závaží 317-009-600 (pro jmenovité hodnoty 1 mg - 500 mg (jednotlivě) \| pro třídy E1 - M3 \| pro tvar zlomkový gram) |
| 318-270 | Štětec 318-270 |
| 338-090-200 | Dřevěné pouzdro na závaží 338-090-200 (pro jmenovité hodnoty 1 mg - 500 mg (jednotlivě) \| pro třídy E1 - M2 \| pro tvar knoflík/kompaktní) |
| 347-009-400 | Plastové pouzdro na závaží 347-009-400 (pro jmenovité hodnoty 1 mg - 500 mg (jednotlivě) \| pro třídy E1 - M2 \| pro tvar knoflík/kompaktní) |

## SLUŽBY

| Model | Popis |
|---|---|
| 920-350 | Označení laserovým gravírováním (individuální označení) KERN 920-350 |
| 920-351 | Označení kalibračních závaží (poslední číslice sériového čísla) KERN 920-351 |
| 921-456 | Zaručená kladná odchylka (> +1/3 OIML) KERN 921-456 |
| 962-456 | Kalibrační list DAkkS 962-456 |
| 962-456R | Opakovaná kalibrace DAkkS 962-456R |

# KERN přehled piktogramů




Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den




Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny